



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-15/24

Tarnów, 2025-03-14


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: przewodników angioplastycznych i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4.** Wnioskujemy o rezygnację z konieczności stworzenia depozytu w Pakiecie 3 oraz 4, z uwagi na fakt, iż przewodniki są sprzedawane w opakowaniach po 5 sztuk.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 Y-Konnektora typu "muszelka", o systemie zamykania push-push, z podwójnym zaworem silikonowym, o średnica wewnętrznej 9F / 3 mm z przedłużaczem o dł. 20 cm. W załączeniu zdjęcie.



3. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej w zakresie całego zadania prosimy o dopuszczenie y-konnektora typu GOODMAN o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienia o **średnicy 11Fr** (wymagane 7Fr) – W WERSJI Z DRENEM LUZ BEZ DRENU DO DOWOLNEGO WYBORU - Rysunki poglądowe poniżej.

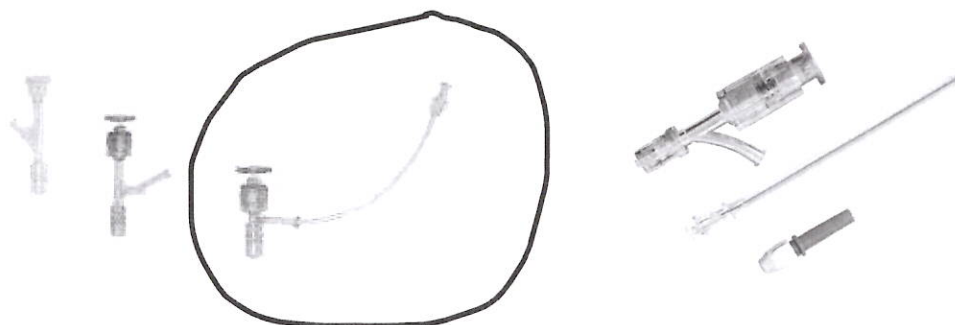

4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przewodników angioplastycznych do zabiegów planowych i bifurkacji – spełniających kluczowe warunki SWZ (tj.: długości: 190 cm oraz

300 cm, średnica przewodnika 0.014", dostępne końcówki przewodnika o profilu: „J” i „prostym” – dającym się kształtować, przewodnik wykonany z jednego kawałka drutu typu "core to tip", pokrycie hydrofilne), dla których oferujemy dostępne końcówki o sztywności: 0.6g, 0.7 oraz 1.0g (dodatkowa korzyść wyboru) i dla których końcówka platynowa ma długość 3cm a warstwa hydrofilna: 28cm lub 40cm długości (do wyboru Zamawiającego – dodatkowa korzyść)

PTCA Guidewire



Distal tip:

- 1) Easy to shape
- 2) Possible to shape multiple times.
- 3) Hydrophilic coating is applied to increase the crossability and deliverability.



Distal tip:

- 4) Platinum coil provides excellent radiopacity.
- 5) Integral core wire structure (Core-to-tip design).
- 6) Optional to connect with extension wire.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z konieczności stworzenia depozytu w **Pakiecie Nr 3** oraz **Pakiecie Nr 4**.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7** opisanego w pytaniu Y-konektora, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7** opisanego w pytaniu Y-konektora.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** przewodników angioplastycznych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek